



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE MASA

Certificado No.: M01-62728-2
Certificate Number

Edición: 0

ISO/IEC 17025:2017
10-LAC-062

Laboratorio de
calibración

Cliente:
Customer

Concesión Vial De Los Llanos S.A.S.

Oportunidad:
Opportunity Number

AUT 48727

Dirección:
Address

Kilómetro 18 + 900 Vía Villavicencio - Puerto Lopez

Numero de Cliente:



2748778658

Ciudad:
City

Villavicencio - Meta

Contacto:
Contact

Juan Felipe Ramos Ospina

Correo:
Mail

jramos@ccllanos.co

No. Telefónico:
Phone

3102737586

Descripción Instrumento:
Instrument Description

Báscula Camionera

Intervalo de Medición: 0 kg a 100000 kg

Intervalo de Calibración: 1000 kg a 58120 kg

División Escala: 20 kg

Marca:
Manufacturer

Cardinal

Modelo:
Model

225

No. Serie:
Serial Number

E20216 - 0169

Identificación:
ID Number

02794

Fecha de Calibración:
Calibration date

2022-10-18

Fecha de Recepción:
Reception date

2022-10-18

Fecha de Emisión:
Issue Date

2022-10-21

Documento de Referencia:
Reference Document

Guía SIM MWG/cg-v.00 2009

Temperatura:

Min 27,7 °C Max 29,3 °C

Método Utilizado:
Method Used

Comparación Directa

Humedad Relativa:

73,4 %hr 77,6 %hr

Lugar de Calibración:
Calibration Site

Peaje La Libertad

Este certificado de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente autorización por escrito de MetroGlobal S.A.S. Certificados sin firma carecen de validez. Los documentos en formato digital son copias no controladas. El documento original es en formato digital .P7z el cual garantiza la autenticidad del certificado.

This calibration certificate can only be fully disseminated without modification. It may not be reproduced in part, except when MetroGlobal S.A.S. Unsigned certificates are invalid. Documents in digital format are uncontrolled copies. The original document is in digital format .P7z which guarantees the authenticity of the certificate.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren solamente al equipo descrito en este documento, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio de METROLOGÍA GLOBAL S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

The results contained in this certificate were indicated only to the equipment described in this document, as well as to the time and conditions in which the measurements were made. The METROLOGÍA GLOBAL S.A.S. Laboratory is not responsible for any damages that may arise from the inappropriate use of calibrated instruments.

ONAC es signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo MRA de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios ILAC para el reconocimiento mutuo de certificados de calibración.

ONAC is a signatory to the Mutual Recognition Arrangement - MRA of the International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC for mutual recognition of calibration certificates.

Calibrado por:

Johan Sebastián Palomá Useche
Metrólogo

Autorizado Por:



Firmado Electrónicamente .p7z
Juan Carlos Ruiz Caballero

Director técnico



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE MASA

Certificado No.: M01-62728-2
Certificate Number

Edición: 0

Documento de Referencia: Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático. SIM MWG7/cg-01/v.00 Ed. 2009.
Reference Document

Procedimiento Utilizado: Procedimiento interno "P.03.3 Calibración de Instrumentos de Pesaje de funcionamiento no automático"
Method used

Trazabilidad Metrológica

Los resultados de este certificado de calibración son trazables al SI por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones que los vincula a patrones nacionales o internacionales, estos patrones son calibrados por laboratorios competentes según los requisitos establecidos en la normal NTC ISO/IEC 17025:2017.

Código	Instrumento	Clase	Fecha Cal.	# Certificado	Laboratorio	Acredita
LPT 017	Lote de pesas de trabajo	M2	2021-12-18	M02-62577	METROGLOBAL S.A.S.	ONAC

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

Prueba de Excentricidad de Carga

Carga Aplicada:	Indicación	Error absoluto
28120 kg		
	28120	0
	28120	0
	28120	0
	28100	20
	28100	20
	28120	0



Prueba de Repetibilidad

Carga Aplicada:	Indicación	Indicación	Indicación
4000 kg			
30000 kg			
58120 kg			
	4000	29980	58100
	4000	29980	58080
	4000	29980	58080

Δ IMAX_{exc} 20


Prueba de Error de Indicación

Carga Aplicada (kg)	Indicación (kg)	Error (kg)	Factor de cobertura k	Incertidumbre Expandida (kg)
1000	1000,0	0	2,11	32
2000	2000,0	0	2,11	32
4000	4000,0	0	2,11	32
6000	6000,0	0	2,10	32
8000	8000,0	0	2,10	32
10000	10000,0	0	2,10	32
12000	12000,0	0	2,09	32
14000	14000,0	0	2,09	33
16000	16000,0	0	2,08	33
18000	18000,0	0	2,08	33
20000	20000,0	0	2,07	34
22000	22000,0	0	2,07	34
24000	24000,0	0	2,06	35
26000	26000,0	0	2,06	35
28000	28000,0	0	2,06	36
30000	30000,0	0	2,05	36
58120	58120,0	0	2,00	68

Desviación Estandar(kg): 0,000 0,000 11,547



FIGURA 1. ERROR, INCERTIDUMBRE EXPANDIDA Y CARGAS / ERROR, EXPANDED UNCERTAINTY AND LOADS

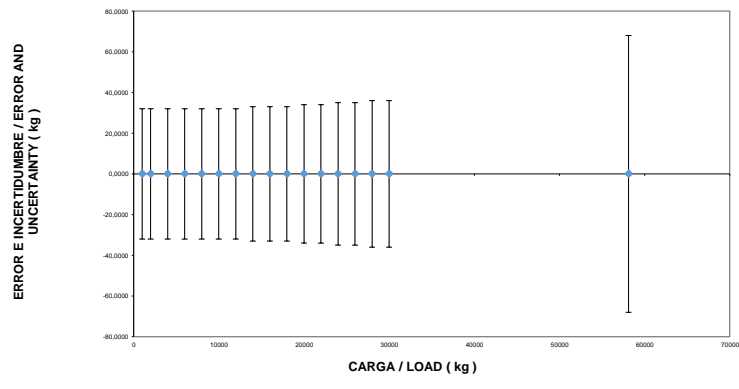

* La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" calculado y tiene una probabilidad de cobertura específica de aproximadamente 95 % v no menor a este valor.
*The reported expanded measurement uncertainty is stated as the standard measurement uncertainty multiplied by the calculated coverage factor "k" and has a specific coverage probability of approximately 95% and not less than this value.

Observaciones:

- A. Las Cargas aplicadas fueron seleccionadas y acordadas con el usuario.
- B. El instrumento bajo calibración se encontró en buen estado de funcionamiento.
- C. "# Edición: "corresponde a que se realizó alguna modificación al certificado de calibración
- D. La indicación de la prueba de error de indicación son el promedio de las mediciones realizadas.
- E. El equipo fue Calibrado hasta 58120 kg tras acuerdo con el cliente.



----- FINAL DEL CERTIFICADO -----